

お知らせ

INFORMATION

No.2022-37

2022 年 11 月

病体生理研究所

検査内容変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記検査項目におきまして、検査内容の変更をさせていただきますので、ご案内申し上げます。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【変更項目】

- ◆ C3 (β_1 C/ β_1 Aグロブリン) [10385] ...検査案内 P59
- ◆ C4 (β_1 Eグロブリン) [10386] ...検査案内 P59
- ◆ IgG [10380] ...検査案内 P73
- ◆ IgA [10381] ...検査案内 P73
- ◆ IgM [10382] ...検査案内 P.73
- ◆ HBV DNA 定量 [TaqMan PCR] [31001] ...検査案内 P64
- ◆ HCV RNA 定量 [TaqMan PCR] [17041] ...検査案内 P65
- ◆ 活性化部分トロンボプラスチン時間 (APTT) [60044] ...検査案内 P99
- ◆ アンチトロンビンⅢ (AT-Ⅲ) [60056] ...検査案内 P99

※ 詳細は裏面参照


《実施日》: 2022 年 12 月 5 日 (月) 受付分より

【変更内容】


検査項目 〔コード〕 検査案内掲載頁 検査実施施設	変更箇所	新	従来	備考
C3 (β_1 C/ β_1 Aグロブリン) 〔10385〕 P.59 B	基準値 (単位)	73 ~ 138 mg/dL	65 ~ 135 mg/dL	JCCLS に沿っ て基準値を見直 した為。
C4 (β_1 Eグロブリン) 〔10386〕 P.59 B		11 ~ 31 mg/dL	13 ~ 35 mg/dL	
IgG 〔10380〕 P.73 B		861 ~ 1747 mg/dL	870 ~ 1700 mg/dL	
IgA 〔10381〕 P.73 B		93 ~ 393 mg/dL	110 ~ 410 mg/dL	
IgM 〔10382〕 P.73 B		M 33 ~ 183 F 50 ~ 269 mg/dL	M 33 ~ 190 F 46 ~ 260 mg/dL	
HBV DNA 定量 〔TaqMan PCR〕 〔31001〕 P.64 B	名称	HBV DNA 定量	HBV DNA 定量 〔TaqMan PCR〕	検査機器および 高感度試薬へ変 更の為。 基準値はメーカ ー設定値です。 検査方法は、 リアルタイム PCR 法で変わ りありません。
	基準値 (単位)	定量 : 1.0 未満 LogIU/mL	定量 : 1.3 未満 LogIU/mL	
	測定範囲	定量 : 1.0~9.0	定量 : 1.3~8.2	
HCV RNA 定量 〔TaqMan PCR〕 〔17041〕 P.65 B	名称	HCV RNA 定量	HCV RNA 定量 〔TaqMan PCR〕	※今回の変更で項 目名称から 〔TaqMan PCR〕を 削除させて頂きま した。
活性化部分トロンボプラ スチン時間 (APTT) 〔60044〕 P.99 B	基準値 (単位)	24.0 ~ 34.0 秒	25.0 ~ 38.0 秒	新試薬へ変更の 為。 基準値はメーカ ー設定値です。
アンチトロンビンⅢ (AT-Ⅲ) 〔60056〕 P.99 B		80 ~ 130 %	80 ~ 120 %	

【従来試薬との比較】

HBVDNA 定量

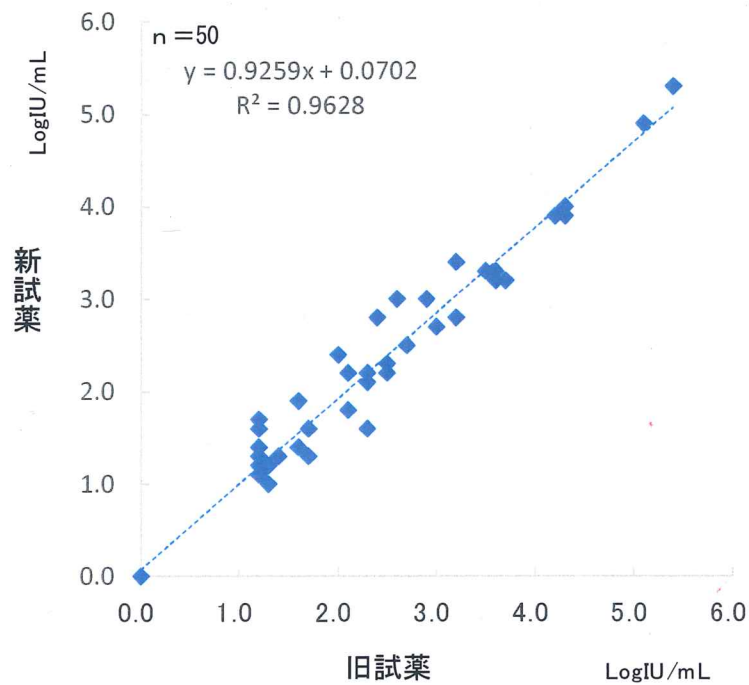


HCVRNA 定量

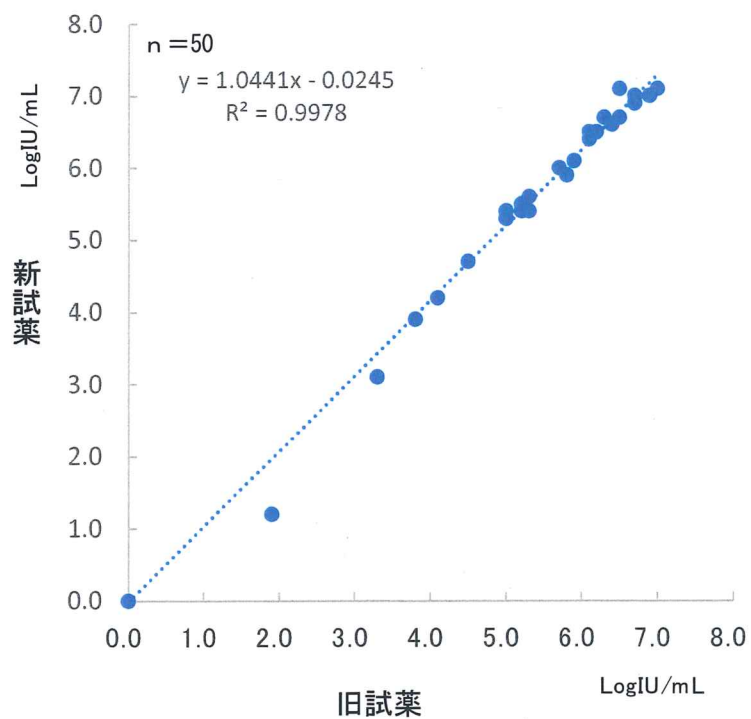

【従来試薬との比較】

活性化部分トロンボプラスチン時間 (APTT)

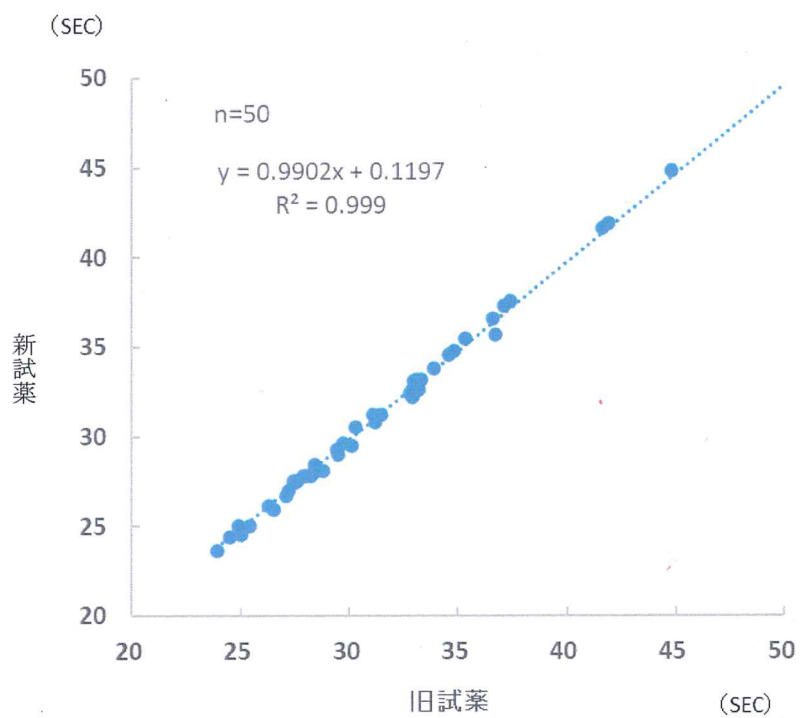

アンチトロンビンⅢ (AT-Ⅲ)

