

お知らせ

INFORMATION



No.2015-35
2015年8月
病体生理研究所

検査内容の変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記項目におきまして測定試薬の製造販売中止に伴い検査内容の変更をさせていただきます。

急なご案内となりましたことをお詫びいたします。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【検査内容の変更について】


- ◆ TPA（組織ポリペプチド抗原）〔11167〕…検査案内掲載 P.43
- ◆ チミジンキナーゼ活性〔13758〕…検査案内掲載 P.45

《変更日》2015年8月22日（土）受付分より

【検査内容の変更について】

検査項目 〔コード〕 検査案内P	変更箇所	新	従来	備考
TPA (組織ポリペプ タイド抗原) 〔11167〕 P.43	検査方法	CLIA	RIA 固相法	* 現試薬の販売中 止のため。 * 基準値はメーカ ー設定値です。
	基準値	75 未満 U/L	70 以下 U/L	
	報告範囲	3 未満、 3~4000、 4001 以上	10 以下、 10~2000 2000 以上	
	検体量	血清 0.5mL 冷蔵	血清 0.4mL 冷蔵	
	所要日数	5~8 日	3~6 日	
チミジン キナーゼ活性 〔13758〕 P.45	検査方法	CLIA	Radioenzyme Assey	* 現試薬の販売中 止のため。 * 基準値はメーカ ー設定値です。
	基準値	7.5 以下 U/L	5.0 以下 U/L	
	報告範囲	2.0 未満、 2.0~9999.9	1.0 以下 1.0~99000000	
	検体量	血清 0.5mL 冷蔵	血清 0.4mL 冷蔵	
	所要日数	5~8 日	4~7 日	

【従来法と新法の相関】

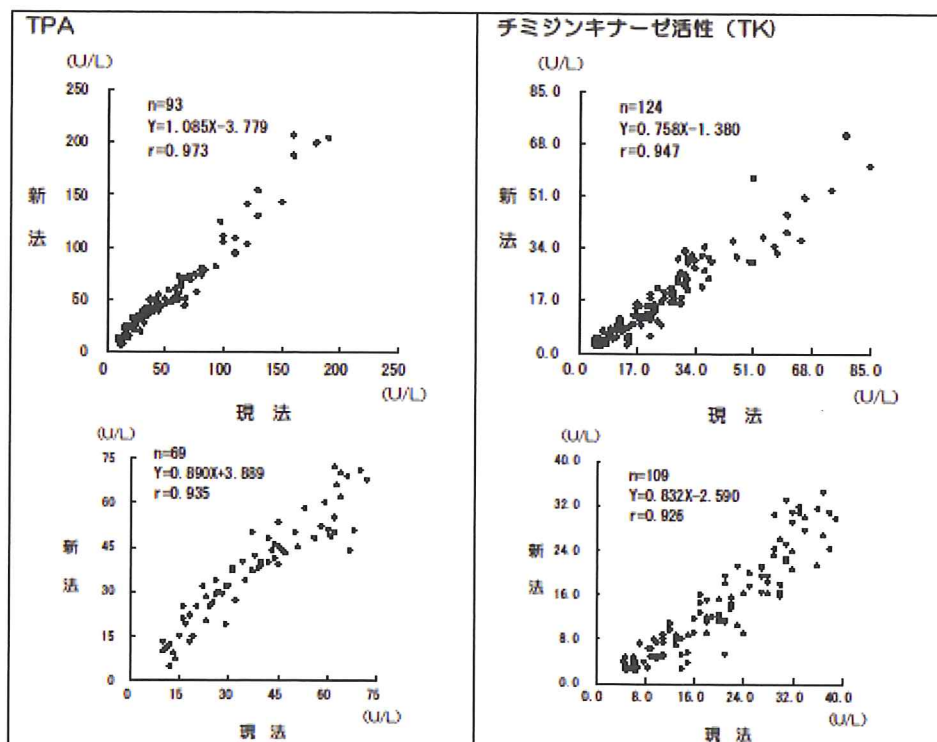

以上