

お知らせ

INFORMATION

No.2017-32

2017年9月

病体生理研究所

検査内容の変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記項目におきまして、検査内容の変更をさせていただきます。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【検査内容が変更となる項目】


◆プレセプシン [16958] …検査案内掲載 P.62 検査実施施設M

《変更日》2017年9月30日（土）受付分より

【検査内容の変更について】

検査項目 〔コード〕 検査案内掲載頁 検査実施施設	変更箇所	新	従来	備考
プレセプシン 〔16958〕 P. 62	基準値	敗血症（細菌性）診 断のカットオフ値 500 pg/mL	314 未満 pg/mL (敗血症診断の カットオフ値：500)	全自動分析装置 用試薬への変更 に伴い、従来の 基準値（314 未 満 pg/mL）を廃 止し、基準値を 敗血症（細菌性） 診断のカットオフ値 に変更致しま す。 検体採取方法、 その他の変更は ありません。
	M 報告 下限値	50.0 未満 pg/mL	20.0 未満 pg/mL	

【従来法と新法の相関】

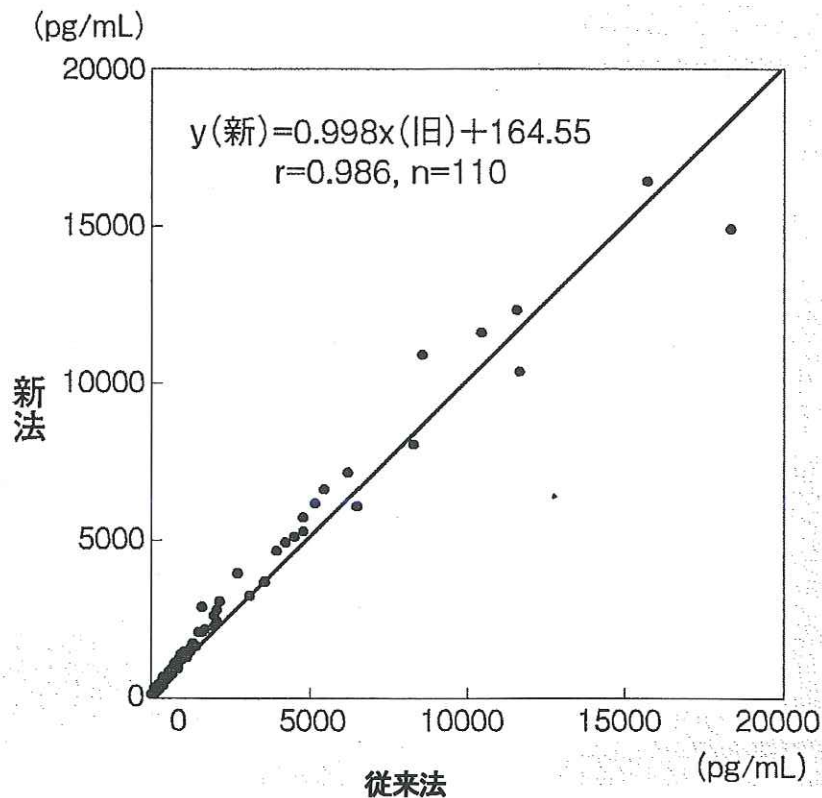

(LSI メディエンス社内データ)

以上