

お知らせ

INFORMATION

No.2018-26
2018年9月
病体生理研究所

新規受託開始および受託中止のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記検査項目におきまして、新たに受託を開始させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。併せて旧検査コードにつきましては試薬販売中止のため、受付中止とさせていただきます。

何卒、ご利用頂けますようご案内申し上げます。

敬具

記

【新規受託開始について】

- ◆ 抗 IA-2 抗体 EIA 法 [16400] …検査実施施設 (M)

※項目情報裏面参照

《受託開始日》：2018年9月29日（土）受付分より

【検査受付中止について】


- ◆ 抗 IA-2 抗体 [13301] …検査案内掲載 P42 検査実施施設 (M)

《最終受付可能日》2018年9月28日（金）受付分まで

【新規項目情報】

項目名称	抗 IA-2 抗体 EIA 法
コード	16400
検体材料	血清 0.4mL
保 存	冷蔵
検査方法	EIA 法
基準値 (単位)	0.6 未満 U/mL
所要日数	4~11 日
実施料 (区分)	213 点 (D008 39) ※内分泌学的検査包括項目
判断料	生化学検査Ⅱ 144 点
備 考	現行試薬の販売中止に伴い、抗 IA-2 抗体の測定試薬を同一メーカーが販売する RIA 試薬から EIA 試薬に変更いたします。 なお、基準値を測定試薬の添付文書記載値に変更します。

【新法と旧法の相関】

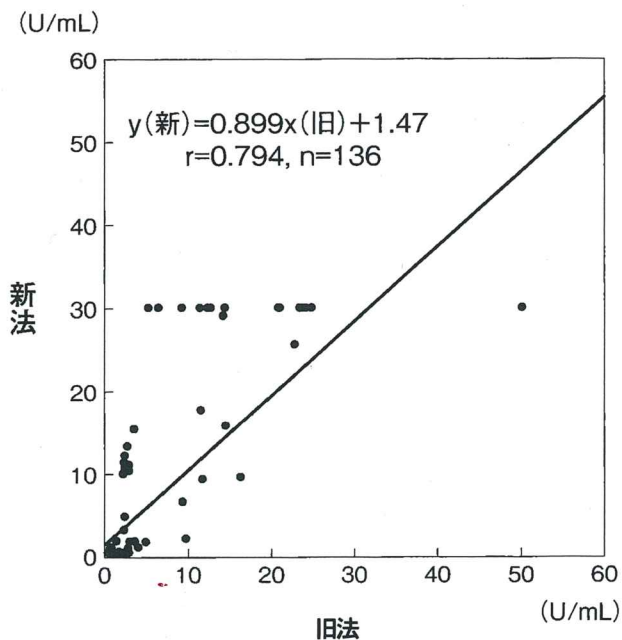

		旧法	
		陰性 (-)	陽性 (+)
新法	陰性 (-)	61	26
	陽性 (+)	0	49

陰性一致率 : 100% (61/61)

陽性一致率 : 65.3% (49/75)

判定一致率 : 80.9% (110/136)

(LSI メディエンス社内検討データ)

参考文献 : 川崎英二 他, 医学と薬学 75 : 669~680, 2018.

以上